



Ställ in önskat rörelseomfång

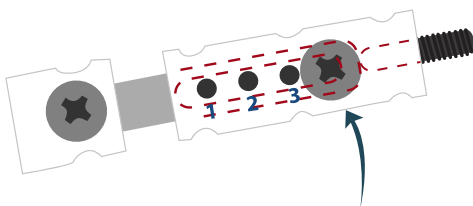


För att ställa in önskat rörelseomfång, sätt en skruv i det hål där du vill ha rörelsens stopp (här i exemplet hål nr.4).

Ju längre skenan är ute desto mer ökar rörelsen.

Ändra vinkeln i leden

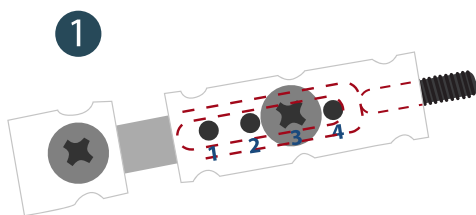


1. För att ändra vinkeln i leden, skruva ur skruven ur hål nr.4 utan att ändra läget på skenan och skruva i skruven i hål nr.3.

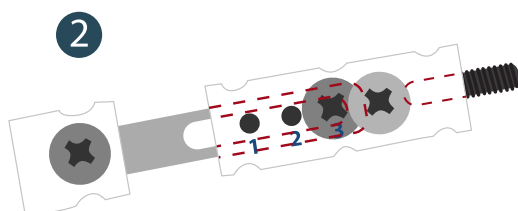


2. Dra skenan utåt så att den stoppar mot skruven i hål nr.3. Skruva därefter i en skruv i hål nr.4 = låst/ rigid-läge.


Olika lägen för önskat rörelseomfång

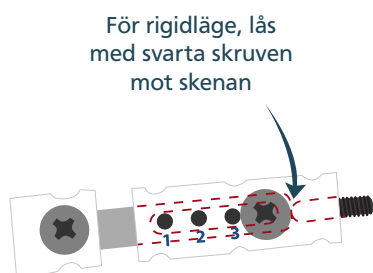


Läge 4, minst vinkel. Om du önskar rigidläge låser du här genom att skruva in den svarta skruven tills den tar emot skenan.

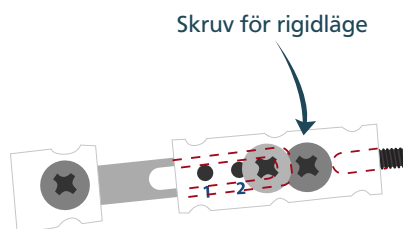

Läge 3. Om du önskar rigidläge låser du här med en skruv i hål nr.4. alternativt skruva in den svarta skruven tills den stoppar mot skenan.

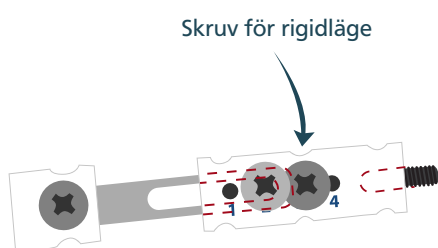

Läge 2. Om du önskar rigidläge låser du här med en skruv i hål nr.3. alternativt skruva in den svarta skruven tills den stoppar mot skenan.

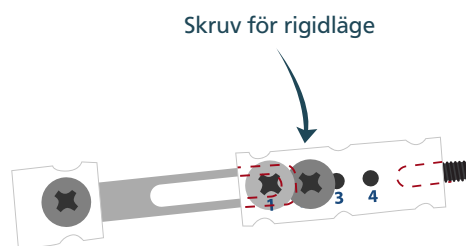


Läge 1, störst vinkel. Om du önskar rigidläge låser du här med en skruv i hål nr.2. alternativt skruva in den svarta skruven tills den stoppar mot skenan.

OBS! De tvärgående skruvarna ska gå igenom båda hålen i rörelsebegränsarens skal. Var därför noga med att skruva i dem ordentligt och välja de längre medföljande skruvarna om så behövs.

För stopp vid tillbakagången


Du kan alltså få rigidläge genom att antingen låsa bygelns med en stoppskruv i hålet ovanför det önskade rörelsestoppet eller uppifrån med den svarta skruven. Ju mer du skruvar in den svarta skruven desto tidigare kommer stoppet. Om man vill låsa längre ner så använder du den längre svarta skruven som följer med vid leverans.

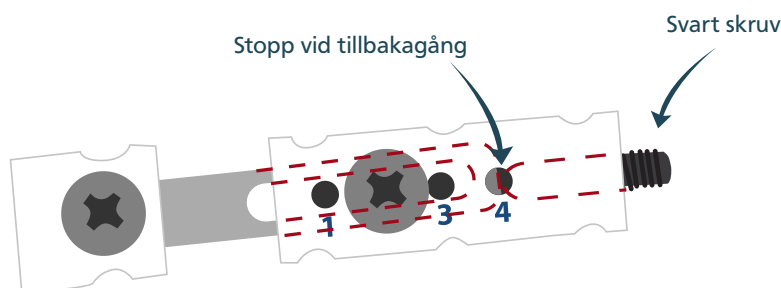

Scandi
orthopedic

Stopp vid tillbakagång - rörelse

Exempel med skruv i hål nr.1.

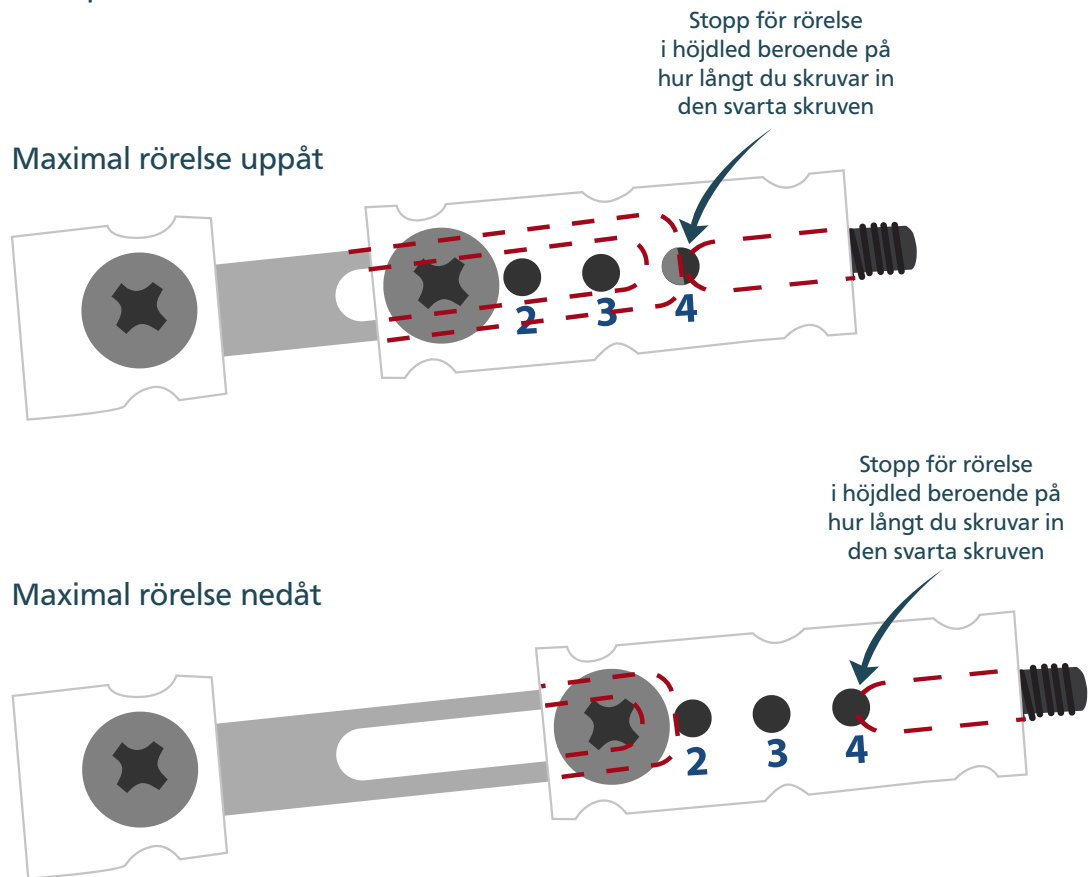

Scandi
orthopedic